点滴ポールスタンド取扱説明書

使用する前にこの取扱説明書をよく読み正しく設置のうえ注意事項・取り扱い等について十分に把握してからご使用下さい。

安全上のご注意

・上部ポールを保持しない状態で高さ調節用カプラを開放した場合、上部ポールが落下しアーム部と下部ポールの間で手を挟む等、身体に危険を及ぼす可能性があります。高さ調整を行う場合は必ず上部ポールを保持した状態で行って下さい。
・上部ポールの高さ調整を行う時は点滴容器を取り外してから行って下さい。

・車椅子に設置した状態で最伸長した場合、アーム部が車椅子補助者の顔の高さになり、その状態で段差の乗り上げ等の為に車椅子を傾ける操作を行うとアームが顔に接触する恐れがあります。車椅子補助者は急激な動作を避け安全に利用できるよう注意して下さい。

車椅子への取り付け方

1. 上部取付金具に下部ポールを通す（仮締め）「写真①」
2. 車椅子のハンドルに上部取付金具を固定する（仮締め）「写真②」
3. 車椅子の車輪固定用中央パイプに下部取付金具を挟み込む様に固定する（仮締め）
4. 下部固定金具のパイプにポールを差し込む。その時に高さ調節用カプラの突起ボスの位置を下部固定用パイプにあいている穴の位置と同一直線上になる様に固定する（カプラ操作位置を固定する為）
5. ポールが垂直になる様に下部固定金具のスライド調整をして固定する。併せて上部ハンドルの固定位置も調整する。
6. 位置が定まったら上部固定金具（4箇所）下部固定金具（3箇所）を工具（プラスドライバー・スパナ・ラチェットレンチ）を使用してロックする。

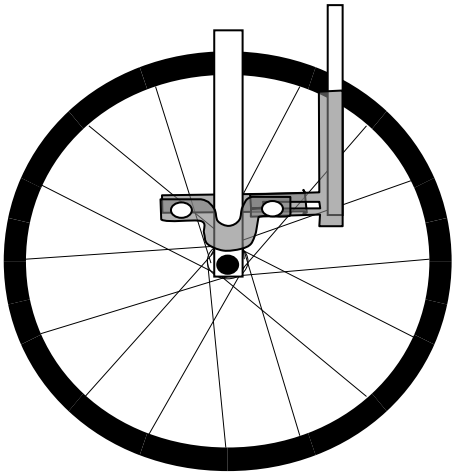

点滴ポールの高さ調整

1. 上部ポールを保持する。
2. カプラの「切り欠き溝」と「突起ボス」を位置合わせする。
3. 外径部品を押し下げながら上部ポールを動かし高さを調整する。
4. 最適な高さ付近で外径部品を押し下げるのを止め、さらに上部ポールを動かすと溝でロックされる。
5. 不意の動作で上部ポールの位置が変わらないように安全ロックを掛ける場合はカプラの外径部品を回転させ「切り欠き溝」を「突起ボス」よりずらします。（使用時は必ずこの状態でご利用下さい。）

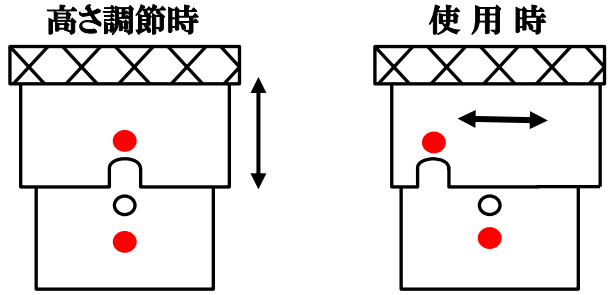

各部の名称

この取り扱い説明書では品物の各部を下記のように呼称しています。

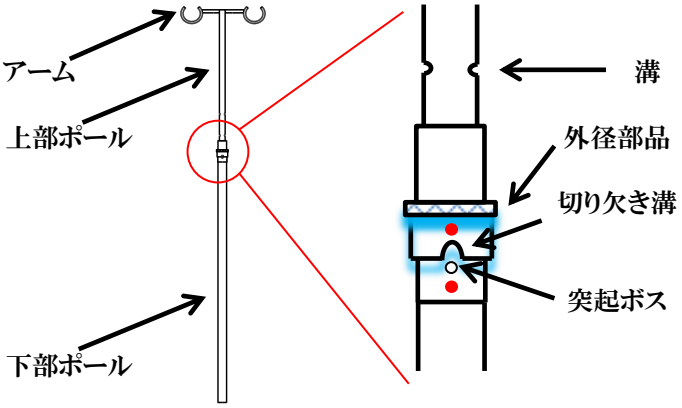

①上部取付金具

この部分を車椅子のハンドル付近の設置可能なポールに取

②上部取付金具の取付見本

③下部取付金具

この部分を車椅子の足の所で設置可能なポールに取り付けて下

株式会社 樋原製作所
〒593-8312 大阪府堺市西区草部780番地
TEL072-275-0489 FAX072-271-1318